Cincha para el hombro especializada

Número de pieza: 235679

INSTRUCCIONES DE USO

Lea el manual de usuario del dispositivo antes de usarlo

Para hacer otro pedido, llame a Empi al **800.328.2536**

Electrodos StimGel de Empi - 199599-001 (paquete de cuatro)

La **cincha activa para el hombro de EMPI** es parte de un sistema diseñado para brindar una estimulación eléctrica a la zona del hombro y un alivio sintomático y tratamiento del dolor del hombro en general. La cincha especializada está compuesta por un material textil transpirable y ligero que envuelve el hombro y se asegura con Velcro™.

USO DE LOS ELECTRODOS

Puede prolongar el uso de los electrodos siguiendo estas recomendaciones:

- Limpie, enjuague y seque la piel antes de cada uso
- Almacene los electrodos como se indica en las instrucciones de embalaje
- Si el gel del electrodo se seca, puede agregar unas gotas de agua a la superficie de gel (del lado que se adhiere) para recuperar el gel adhesivo del electrodo. Antes de aplicar sobre la piel, permita que el electrodo descanse durante unos minutos para que vuelva a fijarse.

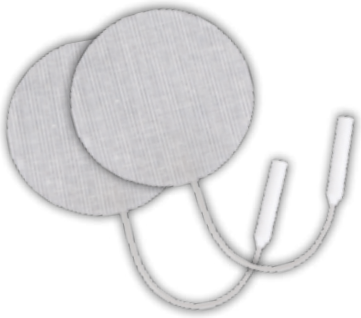

LAVADO DE LA CINCHA

- Lavar a mano, 40 °C (104 °F)
- Lavar con cuidado y utilizar un detergente suave
- No utilizar acondicionador ni lejía y no secar en secadora
- No retorcer, no planchar, no limpiar en seco
- Secar con la cincha extendida

Para hacer otro pedido, llame a Empi al **800.328.2536**

Electrodos StimGel de Empi - 199599-001 (paquete de cuatro)

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Ajuste la correa larga en ambos extremos si no viene así de fábrica.

   Para calcular la longitud de la correa para el pecho, sostenga el extremo superior de la tela más larga hasta el extremo del hombro en tratamiento (el hombro en tratamiento es el izquierdo en la imagen) y el extremo de la correa más larga plegada en el extremo del otro hombro.

   La distancia entre estos dos puntos al estirarse debe ser aproximadamente igual a la distancia entre los extremos de los hombros.

2. Si la correa más larga plegada tiene aproximadamente la misma longitud desde el extremo de cada hombro, afloje la hebilla delantera solo para seguir ajustando.

3. Si la longitud de la correa es demasiado corta o larga, ajuste las correas de cada extremo para igualar la distancia aproximada desde cada extremo de los hombros.

4. Desenganche la correa más corta a fin de que coincida con el mismo lado de la correa larga.

5. Coloque la solapa de la cincha extendida de manera que el interior (con domos de metal conductivos) quede mirando hacia arriba. El lado de las correas debe quedar del lado del hombro en tratamiento.

6. Retire el protector del lado de la CUADRÍCULA de los electrodos StimGel.

7. Presione el lado de la CUADRÍCULA del electrodo StimGel sobre las zonas conductivas en la cincha.

ADVERTENCIA: *Los electrodos StimGel deben cubrir todas las zonas conductivas antes de su uso.*

8. Retire el protector restante y GUÁRDELO para volver a aplicarlo a los electrodos StimGel entre usos.

9. Aplique los electrodos inferiores firmemente en el hombro en tratamiento como se muestra en la imagen. Los electrodos inferiores deben estar cerca del extremo del músculo del hombro.

PASO 1.

PASO 2.

PASO 3.

PASO 6.

PASO 7.

PASO 9.

10. Lleve la cincha hacia arriba y presione firmemente en la parte superior de la cincha donde ambos electrodos tocan la piel. La línea indicadora blanca en la cincha (ver imagen) debe estar en la parte superior dividiendo el músculo del hombro en dos (a un lado). Vuelva a aplicarlo si la línea blanca no está alineada correctamente.

Nota: Todos los electrodos deben estar en contacto con la piel y NO encima de la ropa (camiseta, tira del soutien, etc.).

11. Si es necesario, ajuste la posición de la solapa superior delantera de manera que el electrodo quede delante del músculo del hombro (no sobre el hueso). Las solapas pueden ajustarse moviendo la posición del Velcro™ dentro de la cincha. La camiseta o la tira del soutien pueden quedar delante de la solapa, pero no del Velcro.

12. Pase la mano debajo del brazo, tome la correa corta y pásela por el aro. Tire de la correa y pegue el Velcro debajo del brazo de manera que quede cómodo.

13. Tome la correa larga y pásela por detrás. Tire por la espalda pasando por la axila y luego hacia el pecho. Abroche la hebilla al frente.

14. Si la correa es demasiado corta o larga, afloje la extensión de Velcro de la correa larga para ajustar el largo.

15. Tome el dispositivo de extensión (con la perilla) desde el extremo de la cincha y ajústelo con Velcro hacia abajo y al frente para que el dispositivo sea de fácil alcance.

16. Adhiera el dispositivo TENS haciendo clic en la perilla sobresaliente (conector). Encienda el estimulador y ajústelo según las instrucciones del dispositivo o el médico para el tratamiento.

17. Cuando finalice la sesión de estimulación, apague el estimulador.

PASO 10.

PASO 11.

PASO 12.

PASO 13.

PASO 15.

PASO 16.

OTROS AJUSTES:

A. Ajuste de la colocación de los electrodos

Todas las zonas conductivas se pueden mover y volver a aplicar con Velcro en la cincha para ajustar en la posición correcta.

B. Recorte para ajuste personalizado

Quite la extensión de Velcro del extremo de la correa. Recorte la correa del largo deseado y vuelva a adherirla al Velcro.

C. Incorporación de una correa de extensión para un ajuste personalizado

Si necesita una correa larga para la zona del pecho, puede agregar una correa de extensión para obtener un mejor ajuste. Quite la extensión de Velcro y deslice el extremo de la correa larga de la hebilla.

Coloque la correa larga a través del aro de la correa de extensión. Vuelva a aplicar la porción de Velcro en el extremo y engánchelo para asegurar la correa de extensión.

Deslice el extremo de la correa de extensión de Velcro por la hebilla de la correa de extensión y asegúrela.

D. Incorporación de una almohadilla para mayor comodidad

La cincha especializada está diseñada para que sea cómoda. No obstante, se puede agregar una almohadilla a la correa larga para brindar una mayor comodidad en la zona del pecho/de la axila.

Luego de colocar la cincha para el hombro, desate la correa larga y deslícela por los aros de la almohadilla.

Aplique la cincha como antes y ajuste la almohadilla para disminuir la presión en la zona del pecho/de la axila.

A.

B.

C1.

C2.

C3.

D.

CONSERVACIÓN:

- Retire la cincha lentamente. Los electrodos StimGel se despegarán de la piel y permanecerán pegados a la cincha. Los electrodos permanecerán en la cincha para su almacenamiento.
- Vuelva a colocar en el electrodo el protector que guardó. Asegúrese de colocar el lado que dice "ON" contra la superficie del electrodo StimGel.
- Pliegue la cincha y guárdela en su envase hasta el próximo tratamiento. Vuelva a colocar los protectores, pliegue la cincha y guárdela en la bolsa con cierre reutilizable para prolongar la vida útil de los electrodos StimGel.

Unidad Empi Active en tamaño real

La programación con un solo toque lo convierte en uno de los dispositivos TENS más sencillos del mercado.

El diseño delgado permite usarlo de manera simple y discreta durante las actividades cotidianas

En EE. UU., la ley federal estipula que este dispositivo se venda exclusivamente por médicos u otros profesionales autorizados o con prescripción médica. Se debe usar con un neuroestimulador aprobado para la distribución dentro de Estados Unidos.

INDICACIONES:

El sistema está indicado para el alivio sintomático y el tratamiento del dolor crónico intratable, el tratamiento coadyuvante del dolor posquirúrgico y postraumático agudo y el alivio del dolor asociado con la artritis.

MANTENIMIENTO:

Verifique la cincha especializada antes de cada uso para detectar signos de desgaste o daño. Reemplace los electrodos StimGel cuando sea necesario. Consulte la sección Uso de los electrodos para obtener recomendaciones de mantenimiento. Consulte la sección Lavado de la cincha o la etiqueta en la cincha para obtener las instrucciones de lavado.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Para obtener información sobre riesgos pertinentes, contraindicaciones, advertencias, precauciones y efectos secundarios adversos, consulte el Manual del operador del dispositivo de electroterapia. Si utiliza electrodos StimGel demasiado pequeños en el dispositivo puede sufrir quemaduras térmicas. La cincha nunca se debe utilizar sin electrodos StimGel. La cincha especializada no se debe usar como soporte para el hombro o durante actividades deportivas. La cincha para hombros es para uso en un solo paciente. No comparta la cincha con otras personas ya que puede correr el riesgo de experimentar reacciones adversas o contraer enfermedades.

PRECAUCIÓN:

No aplicar sobre la piel dañada. En caso de que aparezca una erupción o quemadura en la piel, discontinúe el uso de inmediato y comuníquese con su médico.

GARANTÍA DE 90 DÍAS:

Empi reparará o sustituirá, en sus instalaciones, cualquier producto defectuoso. Esta garantía no se aplica a productos dañados por uso incorrecto o reparados o alterados por alguien que no sea Empi en sus instalaciones de Clear Lake, SD.

Esta garantía sustituye cualquier otra garantía, expresa o implícita. Ninguna persona está autorizada a asumir compromisos en nombre de Empi en lo relacionado con la garantía más allá de lo expresado en este documento.

NOTA: El período de garantía comienza a partir de la fecha en que se compró al fabricante.

Empi

Sin látex

Empi, Inc.
205 Highway 22 East
Clear Lake, SD 57226
Empi.com
800.328.2536

Hecho en México para Empi.

360417 Rev A ©2013 Empi, 06/13 Reservados todos los derechos.
Precaución: Dispositivo de venta exclusiva, que deberá ser efectuada por un médico o bajo prescripción facultativa, según lo estipulado en las leyes federales.

DJO GLOBAL